Certificate of performance


witeg GERMANY

ISO 9001 CERTIFIED

Article:	**3 510 101**
Grad. pipettes, 1:0,01 ml, AS, conf. cert.	

Batch:	33-26	**Serial:**	
Measuring Nr.	80167	**Batch size:**	2448

Volume:	**1,0000 ml**	**0,6000 ml**	**0,2000 ml**
Tolerance:	± 0,0070 ml	± 0,0070 ml	± 0,0070 ml
Average value:	0,9969 ml	0,6022 ml	0,2015 ml
Deviation:	0,0016 ml	0,0019 ml	0,0010 ml
Precision (CV):	0,1551 %	0,3187 %	0,5203 %

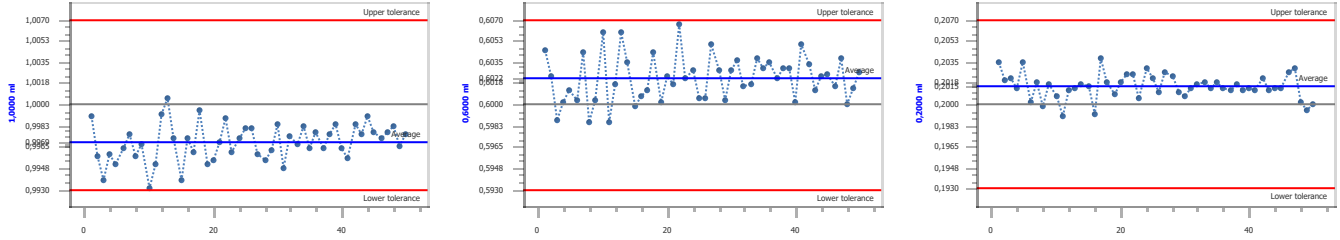

These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20 °C). The test was effected according to ISO 835

witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Germany
+49 (0) 9342 / 9301-0
info@witeg.de

Operator:	7
Date:	14.10.2026
Balance:	Sartorius - LE244S-0CE

DE-M